

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Волгодда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольяти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Черяповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31


<https://kavo.nt-rt.ru> || koc@nt-rt.ru

Воздушные скейлеры SONICflex quick 2008 S, 2008 LS

Инструкция по эксплуатации

SONICflex quick 2008 S - REF 1.007.0541

SONICflex quick 2008 LS - REF 1.007.0540

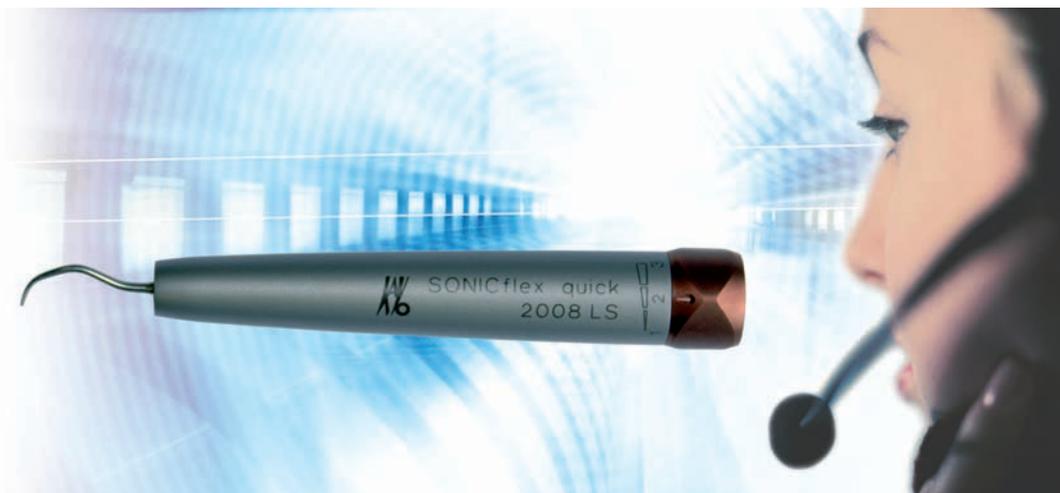

1 Информация для пользователей

Многоуважаемый пользователь!

KaVo предлагает вам свое новое высококачественное изделие. Для обеспечения бесперебойной, экономной и безопасной работы следует соблюдать приведенные ниже указания.

© KaVo Dental GmbH

Символы

	См. главу «Техника безопасности/предупреждающий знак»
	Важная информация для пользователей и технических специалистов
	Стерилизация паром 134 °C -1 °C/+4 °C (273 °F -1,6 °F/+7,4 °F)
	Термодезинфекция
	Маркировка CE (Communauté Européenne). Изделие с этой маркировкой отвечает требованиям соответствующей директивы ЕС.
	Действия, которые нужно выполнить

Целевая группа

Данный документ предназначен для врача-стоматолога и его ассистента. Глава "Ввод в эксплуатацию" предназначена также для технических специалистов.

2 Безопасность

2.1 Указания по технике безопасности

2.1.1 Предупреждающий знак



Предупреждающий знак

2.1.2 Структура



ОПАСНОСТЬ

Во введении описывается вид и источник опасности.

В данном разделе описаны возможные последствия несоблюдения указаний.

- ▶ Опциональная операция содержит необходимые меры по предотвращению опасностей.

2.1.3 Описание степеней опасности

Приведенные здесь указания по технике безопасности с тремя уровнями опасности служат для предотвращения материального ущерба и травм.



ОСТОРОЖНО!

ОСТОРОЖНО!

обозначает опасную ситуацию, которая может приводить к материальному ущербу или легким или средней тяжести травмам.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

обозначает опасную ситуацию, которая может привести к тяжелым или смертельным травмам.



ОПАСНОСТЬ

ОПАСНОСТЬ

обозначает максимальный риск в связи с ситуацией, которая может приводить непосредственно к тяжелым или смертельным травмам.

2.2 Указания по технике безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность для персонала, использующего прибор, и пациентов.

В случае повреждений, нерегулярного рабочего звука, слишком сильной вибрации, нетипичного нагревания, а также если насадка не закреплена.

- ▶ Прекратить работу и проинформировать сервисную службу.

**⚠ ОСТОРОЖНО!****Травмы или повреждения из-за износа..**

Неравномерные шумы при работе, слишком сильные или слишком слабые вибрации или если отсоединяется наконечник инструмента.

- ▶ Прекратить работу и проинформировать сервисную службу.

**⚠ ОСТОРОЖНО!****Преждевременный износ и неисправности из-за неправильной укладки на хранение перед длительными перерывами в работе.**

Сокращение срока службы изделия.

- ▶ Перед длительными перерывами в работе необходимо в соответствии с руководством очистить медицинское изделие, выполнить операции по уходу, после чего хранить в сухих условиях.

**Указание**

При уложенном инструменте SONICflex в целях обеспечения безопасности рекомендуется установить на насадку динамометрический ключ в качестве защиты от травм.

К выполнению ремонта и технического обслуживания изделия KaVo допускаются:

- Технические специалисты представительств KaVo во всем мире
- Технические специалисты, обученные специально в компании KaVo

Для обеспечения бесперебойной работы необходимо обрабатывать медицинское изделие методами обработки, описанными в инструкции по эксплуатации оборудования KaVo, и применять указанные средства и системы для ухода. KaVo рекомендует установить периодичность технического обслуживания, при котором специализированной фирмой проводится анализ медицинского изделия в отношении очистки, обслуживания и функционирования. Данная периодичность должна соответствовать частоте использования оборудования. Обслуживание разрешается проводить только обученному в компании KaVo персоналу ремонтных мастерских, который использует оригинальные запасные части от KaVo.

2.2.1 Насадки SONICflex**⚠ ОСТОРОЖНО!****Опасность травмирования и инфицирования при замене насадок SONICflex.**

Это может приводить к серьезной опасности для пользователя.


- ▶ Для проверки, установки и снятия насадок SONICflex использовать перчатки или пальчики.

**Указание**

Мы рекомендуем заменять насадки SONICflex каждые 9-12 месяцев.

**Указание**

Степень износа насадки регулярно проверять с помощью поверочной карты (Арт. № 1.001.6958).



Может случиться, что вследствие длительной нагрузки или повреждения (падения на пол или механического изменения первоначальной формы) произойдет разрушение. Поэтому перед каждым использованием легким нажатием большим или указательным пальцем проверять эксплуатационную надежность и безопасность насадки.

- ▶ В качестве дополнительной гарантии безопасности нагрузить насадки усилием около 10 Н (1 кг) в нерабочем состоянии.

3 Описание изделия



SONICflex quick 2008 S (Арт. № 1.007.0541)



SONICflex quick 2008 LS (Арт. № 1.007.0540)

SONICflex является стоматологическим наконечником согласно ISO 15606. Генерация колебаний осуществляется вращающейся стальной втулкой. В сочетании с различными насадками KaVo создается осциллирующее эллиптическое движение насадки для соответствующей области применения. Внутреннее водяное охлаждение (охлаждение распылением) предотвращает нагрев рабочей зоны и поддерживает чистоту поверхности обработки.



Указание

Работа должна выполняться с указанным развиваемым давлением. После пуска при макс. развиваемом давлении допускается регулировка интенсивности ножной педалью.

3.1 Целевое назначение — использование по назначению

Целевое назначение:

Данное медицинское изделие

- можно использовать только для стоматологического лечения в соответствующей области стоматологии. Запрещается любое использование не по назначению, т.к. это может повлечь опасные последствия.
- SONICflex можно использовать в сочетании с насадками KaVo для удаления зубного камня, профилактики, эндодонтии, пародонтологии, хирургии и в консервативной стоматологии.
- является медицинским изделием, изготовление и использование которого регламентируется соответствующими государственными нормами и правилами.

Использование по назначению:

Согласно этим положениям, данное изделие разрешается применять только опытным пользователям и только в описанных целях. При этом необходимо соблюдать

- действующие правила охраны труда;
- действующие правила предупреждения несчастных случаев;
- данную инструкцию по эксплуатации

Согласно этим положениям пользователь обязан:

- использовать только исправное оборудование;
- использовать оборудование строго по назначению;

- следить за своей безопасностью, а также за безопасностью пациентов и третьих лиц;
- не допускать заражения при пользовании изделием.

3.2 Технические характеристики

Развиваемое давление	2,5 (36) – 3,5 (51) бар (psi)
Расход воздуха	20 - 40 норм. л/мин
Расход воды	30 - 50 мл/мин
Частота	6 – 6,5 кГц
Рекомендуемое усилие прижима	0,1 - 2 Н

SONICflex можно устанавливать на любые быстросменные муфты Sirona (тип: Sirona R/F).

- Амплитуда колебаний на ступени 1 = 120 +/- 15 мкм
- Амплитуда колебаний на ступени 2 = 160 +/- 15 мкм
- Амплитуда колебаний на ступени 3 = 240 +/- 15 мкм



ОСТОРОЖНО!

Соблюдать рекомендации по настройке SONICflex.

Несоблюдение может приводить к опасности для пациента.

- ▶ При использовании ступени 3 строго соблюдать рекомендации по настройке.

3.3 Температура транспортировки и хранения



ОСТОРОЖНО!

Опасность при вводе в эксплуатацию медицинского оборудования после хранения в холодном помещении.

Это может привести к отказу оборудования.

- ▶ Сильно охлажденные изделия перед вводом в эксплуатацию довести до температуры 20 °C - 25 °C (68 °F - 77 °F).

	Температура: от -20 °C до +70 °C (от -4 °F до +158 °F)
	Относительная влажность воздуха: от 5% до 95% без конденсации
	Атмосферное давление: от 700 гПа до 1060 гПа (от 10 psi до 15 psi)
	Защищать от воздействия влаги

4 Ввод в эксплуатацию



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность из-за нестерильных изделий.

Опасность заражения врача и пациента.

- ▶ Перед первым вводом в эксплуатацию и после каждого использования выполнять соответствующую подготовку и, при необходимости, стерилизацию продукта и принадлежностей.

SONICflex можно использовать в сочетании с насадками KaVo для удаления зубного камня, профилактики, эндодонтии, пародонтологии, хирургии и в консервативной стоматологии.

Расход воды установить на стоматологической установке таким образом, чтобы наконечник инструмента с его интенсивностью колебаний распылял воду. Удаление зубного налета важно для гигиены полости рта и тщательного пародонтального лечения. Вибрационная очистка SONICflex - щадящий, быстрый и простой метод. Опираение на соседний зуб облегчает применение и обеспечивает надежное ведение. Ведение инструмента должно быть легким, мягким и быстрым в направлении и вперед, и назад. Правильный метод - это боковая установка инструментальной насадки с параллельным ведением относительно зуба. Насадка должна перемещаться параллельно поверхности зуба, но не боком, чтобы предотвратить повреждение субстанции зуба из-за образования насечек. Специалисты рекомендуют полировать поверхность зуба профилактической головкой KaVo и предназначенными для этого резиновыми колпачками и пастами, чтобы добиться улучшенного эффекта профилактики кариеса.

4.1 Проверка расхода воды



ОСТОРОЖНО!

Перегрев зуба из-за недостаточного расхода воды.

Термическое повреждение пульпы.

- ▶ Расход воды для охлаждения распылением установить на величину не менее 30 см³/мин!

4.2 Подключение к аппаратам



ОСТОРОЖНО!

Повреждения из-за загрязненного и влажного охлаждающего воздуха.

Загрязненный и влажный охлаждающий воздух может приводить к отказам в работе и преждевременному износу подшипников.

- ▶ Необходимо обеспечить подачу сухого, очищенного и не содержащего загрязнений охлаждающего воздуха, соответствующего требованиям ISO 7494-2.

4.3 Монтаж переходника Sirona

- ▶ Переходник Sirona навинтить на шланг турбины.

4.4 Контроль уплотнительных колец



⚠ ОСТОРОЖНО!

Отсутствие или повреждение уплотнительных колец.

Неисправности и преждевременный выход из строя.

- ▶ Убедиться в том, что все уплотнительные кольца имеются на переходнике и не повреждены.

Число имеющихся уплотнительных колец: 4

4.5 Контроль давлений



Надеть контрольный манометр Sirona Prüfstern на быстросменную муфту Sirona.

Индикация давлений:

- Приводной воздух: 2,5 (36) – 3,5 (51) бар (psi)
- Возвратный воздух: < 0,4 (6) бар (psi)
- Вода: 0,8 - 2,5 (11 - 36) бар (psi)
- Спрей-воздух: макс. 2 (29) бар (psi)
- Но спрей-воздух не требуется.

5 Эксплуатация

5.1 Установка SONICflex

ОСТОРОЖНО!



Обеспечить прочность фиксации SONICflex на быстросменной муфте Sirona.

Случайное отсоединение SONICflex от быстросменной муфты Sirona во время лечения может представлять опасность для пациента и пользователя.

- ▶ Перед каждым использованием, потянув за SONICflex, проверять его фиксацию на быстросменной муфте Sirona.

ОСТОРОЖНО!




Неточное соединение, особенно во время задержки работы подсветки.

Неточное соединение может повредить лампу высокого давления быстросменной муфты Sirona или уменьшить срок ее службы.

- ▶ Обратите внимание на точность сцепления.
- ▶ Инструмент SONICflex точно установить на быстросменную муфту Sirona и прижимать назад до тех пор, пока он не зафиксируется с характерным щелчком.

5.2 Снятие SONICflex



- ▶ Держа за быстросменную муфту Sirona, снять SONICflex на себя, слегка поворачивая его.

5.3 Установка насадки SONICflex

ОСТОРОЖНО!



Опасность из-за неправильной укладки насадки в динамометрический ключ.

Грозит опасность травмирования пользователя.


- ▶ При укладке насадки в динамометрический ключ следить за тем, чтобы конец насадки всегда был обращен в направлении паза динамометрического ключа.



Указание

В связи со значительным риском исключения ответственности мы рекомендуем использовать только оригинальные насадки KaVo SONICflex.

- ▶ Требуемую насадку уложить концом вниз в динамометрический ключ и ввинтить в наконечник по часовой стрелке.



Динамометрический ключ служит для замены рабочих насадок SONICflex и для защиты от травм. Для ускорения ввинчивания рекомендуется брать динамометрический ключ в задней тонкой части ручки ①. Для затягивания и отпускания используется большой диаметр ②.



Указание

Щелчок манометрического ключа означает, что насадка правильно затянута.



Указание

При уложенном инструменте SONICflex в целях обеспечения безопасности рекомендуется установить на насадку динамометрический ключ в качестве защиты от травм.

5.4 Снятие насадки SONICflex



- ▶ Динамометрический ключ вставить/установить в/на SONICflex и вывинтить насадку против часовой стрелки.

5.5 Регулировка мощности



Регулировочным кольцом на SONICflex устанавливается уровень мощности 1-2-3.

5.6 Регулировка спрея



- ▶ Повернуть спрей-кольцо на быстросменной муфте Sirona, чтобы отрегулировать долю воды. Различные положения фиксатора позволяют регулировать расход воды.
- ⇒ Вращение по часовой стрелке уменьшает расход воды.
⇒ Вращение против часовой стрелки увеличивает расход воды.

6 Методы обработки согласно ISO 17664



Указание

Описанные ниже методы подготовки действительны для инструмента SONICflex, динамометрического ключа и специальной иглы для сопла.

6.1 Подготовка в месте применения



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность из-за нестерильных изделий.

Из-за зараженных медицинских изделий существует опасность инфицирования.

- ▶ Принять соответствующие меры по защите людей.

- ▶ Сразу же удалите остатки цемента, композита или крови.
- ▶ Медицинское изделие следует обрабатывать как можно скорее после использования.
- ▶ Медицинское изделие следует доставлять на место обработки в сухом виде.
- ▶ Не помещать в растворы и т. п.
- ▶ Насадку удалить из SONICflex динамометрическим ключом.

6.2 Очистка



ОСТОРОЖНО!

Неисправности из-за очистки в ультразвуковом аппарате.


Повреждение изделия.

- ▶ Очищать только в термодезинфекторе или вручную!

6.2.1 Ручная наружная очистка

Необходимые принадлежности:

- Питьевая вода 30 °C ± 5 °C (86 °F ± 10 °F)
- Щетка, например, зубная щетка средней жесткости



- ▶ Очистить щеткой, например, зубной щеткой средней жесткости, под проточной питьевой водой.

- ▶ Подготовка наконечника согласно инструкции по эксплуатации.

6.2.2 Машинная наружная очистка



KaVo рекомендует термодезинфекторы, соответствующие EN ISO 15883-1, используемые со щелочными чистящими средствами со значением pH не более 10 (например, Miele G 7781/G 7881 — квалификационные испытания проводились с помощью программы VARIO-TD, чистящего средства neodisher® mediclean, нейтрализующего средства neodisher® Z и ополаскивателя neodisher® mielclear и касаются исключительно совместимости материалов с изделиями KaVo).

- ▶ Настройки программы и применяемые чистящие и дезинфицирующие средства приведены в инструкции по эксплуатации термодезинфектора.
- ▶ Во избежание повреждения медицинского изделия KaVo следует убедиться, что по окончании цикла медицинское изделие снаружи и внутри сухое, и сразу после этого смазать его специальным средством системы для ухода KaVo.

6.2.3 Ручная внутренняя очистка

Возможна только с применением KaVo CLEANspray и KaVo DRYspray.

- ▶ Укрыть на медицинское изделие пакетом KaVo Cleanpac и надеть его на соответствующий адаптер для ухода. Нажать распылитель аэрозоля 3 раза по 2 секунды. Снять медицинское изделие с насадки и оставить чистящее средство действовать на одну минуту.
- ▶ Затем 3 - 5 секунд промывать средством KaVo DRYspray.

См. также:

- ▶ Инструкция по применению KaVo CLEANspray / KaVo DRYspray

Указание

KaVo CLEANspray и KaVo DRYspray для внутренней очистки вручную поставляются только в следующих странах:

Германия, Австрия, Швейцария, Италия, Испания, Португалия, Франция, Люксембург, Бельгия, Нидерланды, Великобритания, Дания, Швеция, Финляндия и Норвегия.

В других странах осуществляется только внутренняя машинная очистка с помощью термодезинфекторов согласно стандарту EN ISO 15883-1.



Указание

Насадки не укладывать в ванну для боров, т. к. мельчайшие капилляры более не могут быть промыты текущей водой, что может привести к сильной коррозии.



6.2.4 Машинная внутренняя очистка



KaVo рекомендует термодезинфекторы, соответствующие EN ISO 15883-1, используемые со щелочными чистящими средствами со значением pH не более 10 (например, Miele G 7781/G 7881 — квалификационные испытания проводились с помощью программы VARIO-TD, чистящего средства neodisher® mediclean, нейтрализующего средства neodisher® Z и ополаскивателя neodisher® mielclear и касаются исключительно совместимости материалов с изделиями KaVo).

- ▶ Настройки программы и применяемые чистящие и дезинфицирующие средства приведены в инструкции по эксплуатации термодезинфектора.
- ▶ Во избежание повреждения медицинского изделия KaVo следует убедиться, что по окончании цикла медицинского изделия снаружи и внутри сухое, и сразу после этого смазать его специальным средством системы для ухода KaVo.

6.3 Дезинфекция



⚠ ОСТОРОЖНО!

Неисправности из-за использования емкости для дезинфекции или содержащего хлор дезинфицирующего средства.

Повреждение изделия.

- ▶ Дезинфицировать только в термодезинфекторе или вручную!

6.3.1 Ручная наружная дезинфекция



KaVo рекомендует на основе совместимости материалов следующие изделия. Микробиологическое действие должно быть обеспечено производителем дезинфицирующего средства.

- Mikroqid AF Liquid фирмы Schülke & Mayr (жидкость или салфетки)
- FD 322 фирмы Dürr
- CaviCide фирмы Metrex

Необходимые вспомогательные средства:

- Салфетки для очистки изделия.
- ▶ Дезинфицирующее средство разбрызгать на салфетку, затем протереть ею изделие и оставить действовать согласно инструкции изготовителя дезинфицирующего средства.
- ▶ Соблюдайте инструкцию по использованию дезинфицирующего средства.

6.3.2 Ручная внутренняя дезинфекция

Эффективность ручной внутренней дезинфекции должна быть документально подтверждена производителем дезинфицирующего средства. Для изделий KaVo разрешается использовать только дезинфицирующие средства, допущенные KaVo с точки зрения совместимости материалов (напр., WL-cid/фирма ALPRO).

- ▶ Сразу после проведения внутренней дезинфекции смажьте медицинское изделие KaVo специальными средствами, входящими в систему для ухода KaVo.
- ▶ Соблюдайте инструкцию по использованию дезинфицирующего средства.

6.3.3 Машинная наружная и внутренняя дезинфекция



KaVo рекомендует термодезинфекторы, соответствующие EN ISO 15883-1, используемые со щелочными чистящими средствами со значением pH не более 10 (например, Miele G 7781/G 7881 — квалификационные испытания проводились с помощью программы VARIO-TD, чистящего средства neodisher® mediclean, нейтрализующего средства neodisher® Z и ополаскивателя neodisher® mielclear и касаются исключительно совместимости материалов с изделиями KaVo).

- ▶ Настройки программы и применяемые чистящие и дезинфицирующие средства приведены в инструкции по эксплуатации термодезинфектора.
- ▶ Во избежание повреждения медицинского изделия KaVo следует убедиться, что по окончании цикла медицинское изделие снаружи и внутри сухое, и сразу после этого смазать его специальным средством системы для ухода KaVo.

6.4 Сушка

Ручная сушка

- ▶ Сжатым воздухом обдуть снаружи и продуть изнутри, чтобы исчезли все капли воды.

Машинная сушка

Как правило, сушка является составной частью программы дезинфекции термодезинфектора.

- ▶ Соблюдать инструкцию по эксплуатации термодезинфектора.

6.5 Средства и системы для ухода - техническое обслуживание

ОСТОРОЖНО!

Преждевременный износ и выход из строя в результате неправильного обслуживания и ухода.

Сокращение срока службы изделия.

- ▶ Регулярно проводить требуемый уход!



Указание

KaVo предоставляет гарантию безупречного функционирования изделий KaVo только при использовании средств ухода, указанных в списке вспомогательных средств, т.к. именно они проверены на пригодность для наших изделий при соответствующем применении.



Указание

Если обработке мешает выход масла, с учетом технической конструкции при выполнении ухода один раз в неделю от обычной процедуры можно отступить и отказаться от смазки перед стерилизацией.

6.5.1 Уход за динамометрическим ключом




⚠ ОСТОРОЖНО!


Неисправности из-за очистки в ультразвуковом аппарате.

Повреждение динамометрического ключа.

- ▶ Не помещайте динамометрический ключ в ультразвуковой очистительный аппарат.




Если чувствуется неравномерный ход динамометрического ключа, рекомендуется смазать его силиконовой смазкой (**Арт. № 1.000.6403**). Силиконовая смазка нагнетается внутрь динамометрического ключа в прорези и карманы стопорных пружин. Для этого выжать немного смазки размером в рисовое зернышко на палец и ввести в указанном месте (см. стрелки) в динамометрический ключ. Затем повернуть ключ и, при необходимости, досмазать.



6.5.2 Уход с использованием аэрозоля KAVOspray

- ▶ Снять насадку.
- ▶ Надеть на изделие пакет Cleanpac.
- ▶ Надеть изделие на канюлю и нажать на одну секунду распылитель аэрозоля.



6.5.3 Уход при помощи распылителя KaVo SPRAYrotor

- ▶ Снять насадку.
- ▶ Присоединить изделие к подходящему переходнику распылителя SPRAYrotor и надеть на него пакет Cleanpac.
- ▶ Выполнить уход за изделием.

См. также:

- ▣ Инструкция по эксплуатации KaVo SPRAYrotor

6.5.4 Уход при помощи KaVo QUATTROcare

Прибор для очистки и ухода с использованием технологии нарастающего давления, способствующей высокой эффективности данных мероприятий.



Фирма KaVo рекомендует еженедельное выполнение ухода за изделием.

- ▶ Снять насадку.
- ▶ Выполнить уход за изделием.

См. также:

- ▣ Инструкция по эксплуатации KaVo QUATTROcare 2104/2104A

6.6 Упаковка



Указание

Стерилизационный пакет должен быть достаточно большим для инструмента, чтобы упаковка не находилась под механическим натяжением.

Стерилизационная упаковка должна удовлетворять существующим нормам относительно качества и применения и быть пригодной для процедуры стерилизации!

- ▶ Заварите каждое медицинское изделие в отдельную стерильную упаковку!

6.7 Стерилизация

Стерилизация в паровом стерилизаторе (автоклаве) согласно EN 13060/ISO 17665-1

ОСТОРОЖНО!



Преждевременный износ и выход из строя в результате неправильного обслуживания и ухода.

Сокращение срока службы изделия.

- ▶ Перед каждым циклом стерилизации выполнять уход за медицинским изделием при помощи средств для ухода KaVo. Однако при избыточной смазке SONICflex возможно отступление от предписываемых значений.

ОСТОРОЖНО!



Контактная коррозия из-за влаги.

Повреждения изделия.

- ▶ После завершения цикла стерилизации немедленно выньте изделие из парового стерилизатора!



Указание

Снять насадки для стерилизации, а затем просушить медицинское изделие.



Медицинское изделие KaVo устойчиво к воздействию температуры 138 °C (280,4 °F).

Можно выбрать подходящую процедуру стерилизации из представленных ниже (в зависимости от имеющегося в наличии автоклава):

- Автоклав с системой трехэтапного форвакуума:
 - не менее 3 мин при 134 °C -1 °C/+4 °C (273 °F -1,6 °F/+7,4 °F)
- Автоклав с гравитационной системой:
 - не менее 10 мин при 134 °C -1 °C/+4 °C (273 °F -1,6 °F/+7,4 °F)

6.8 Хранение

Подготовленные продукты должны храниться защищенными от пыли и по возможности стерильными в сухом, темном и прохладном помещении.



Указание

Соблюдать срок годности стерильного материала.

7 Вспомогательные средства

Поставляются через специализированные магазины стоматологической техники

Краткое описание материала	Арт. №
Держатель наконечника 2151	0.411.9501
Бумажные прокладки 100 штук	0.411.9862
Пакет Cleanрас 10 штук	0.411.9691
Динамометрический ключ	1.000.4887
Переходник	1.006.5966
Вилочный ключ	0.411.0892
Силиконовая смазка	1.000.6403
Игла для прочистки форсунок	0.410.0911
Вставка для SONICflex	0.411.9902
Распылительная головка SIRONA для KAVOspray	1.005.8365
Муфта ухода SIRONA для QUATTROcare	1.000.7156

Сокращенное наименование материала	№ материала
KaVo CLEANspray 2110 P	1.007.0579
KaVo DRYspray 2117 P	1.007.0580
KaVo Spray 2112 A	0.411.9640
QUATTROcare plus Spray 2140 P	1.005.4525

№	Тип насадки	№ материала
5 A	Scaler Universal	Арт. № 1.005.8949
6 A	Scaler Sichel	Арт. № 1.005.8950
7 A	Scaler Perio	Арт. № 1.005.8951
8 A	Scaler Perio, очень длинный	Арт. № 1.006.1953
12 A	Cem	Арт. № 1.006.2021
-	Насадка Cem	Арт. № 0.571.7142
16 A	Retro цилиндр левый	Арт. № 1.006.2036
17 A	Retro цилиндр правый	Арт. № 1.006.2035
20 A	Retro T-образный левый	Арт. № 1.006.2037
21 A	Retro T-образный Подрезка	Арт. № 1.006.2038
24 A	Rootplaner почкообразный малый левый	Арт. № 1.006.1957
25 A	Rootplaner почкообразный малый правый	Арт. № 1.006.1959
26 A	Rootplaner почкообразный малый универсальный	Арт. № 1.006.1961
27 A	Rootplaner почкообразный большой Perio	Арт. № 1.006.1963
28 A	Micro торпедообразный мезиальный	Арт. № 1.006.1965
29 A	Micro торпедообразный дистальный	Арт. № 1.006.1967
30 A	Micro малый полусфер. мезиальный	Арт. № 1.006.1969

№	Тип насадки	№ материала
31 A	Micro малый полусфер. дистальный	Арт. № 1.006.1971
32 A	Micro большой полусфер. мезиальный	Арт. № 1.006.1973
33 A	Micro большой полусфер. дистальный	Арт. № 1.006.1975
34 A	Prep CAD-CAM мезиальный	Арт. № 1.006.1977
35 A	Prep CAD-CAM дистальный	Арт. № 1.006.1979
42 A	Cariex D 0.8, D 64	Арт. № 1.006.1980
43 A	Cariex D 1.2, D 64	Арт. № 1.006.1981
45 A	Seal конический, D 46	Арт. № 1.007.1503
48 A	Clean (щеткодержатель)	Арт. № 1.006.1982
-	Clean щетка № 1 наполн.	Арт. № 1.004.4125
-	Clean щетка № 2 наполн.	Арт. № 1.004.4126
-	Clean щетка № 3 наполн.	Арт. № 1.004.4127
-	Clean щетка № 4 наполн.	Арт. № 1.004.4128
-	Clean щетка № 5 наполн.	Арт. № 1.004.4129
-	Clean щетка № 6 наполн.	Арт. № 1.004.4130
49 A	Prep gold мезиальный	Арт. № 1.006.1983
50 A	Prep gold дистальный	Арт. № 1.006.1984
51 A	Prep сегам мезиальный	Арт. № 1.006.1985
52 A	Prep сегам дистальный	Арт. № 1.006.1986
55 A	Retro фронт. зуб	Арт. № 1.006.2039
56 A	Retro Finder левый	Арт. № 1.006.2040
57 A	Retro Finder правый	Арт. № 1.006.2041
-	Retro Stopfer левый	Арт. № 0.571.5601
-	Retro Stopfer правый	Арт. № 0.571.5611
58 A	Bevel мезиальный	Арт. № 1.006.1988
59 A	Bevel дистальный	Арт. № 1.006.1990
60 A	Paro прямой	Арт. № 1.006.1934
61 A	Paro левый	Арт. № 1.006.1935
62 A	Paro правый	Арт. № 1.006.1936
66 A	Endo почкообр. большой 117°	Арт. № 1.006.1992
67 A	Endo конический 125°	Арт. № 1.006.1994
68 A	Endo конический 112°	Арт. № 1.006.1996
69 A	Endo почкообр. малый 117°	Арт. № 1.006.1998
70 A	Endo конический 117°	Арт. № 1.006.2000
71 A	Cariex TC 1.0	Арт. № 1.006.2002
72 A	Cariex TC 1.4	Арт. № 1.006.2004
80 A	Bone с 4 режущими кромками	Арт. № 1.006.2006
81 A	Bone сфер. большой, D 46	Арт. № 1.006.2008
82 A	Bone сфер. большой	Арт. № 1.006.2010
83 A	Bone пилообр. сагиттальный	Арт. № 1.006.2012
84 A	Bone пилообр. аксиальный	Арт. № 1.006.2014
85 A	Bone «слоновья нога»	Арт. № 1.007.1624
86 A	Bone распатор	Арт. № 1.007.1625

№	Тип насадки	№ материала
87 A	Bone пылн. полотно	Арт. № 1.007.1626
-	Bone пылн. полотно наполн.	Арт. № 1.006.1405
-	Implant компл.	Арт. № 1.006.2027
-	Implant Pin наполн.	Арт. № 1.003.8168
-	Swing компл.	Арт. № 1.007.1142
-	Swing 015 наполн.	Арт. № 1.006.2042
-	Swing 020 наполн.	Арт. № 1.006.2043
-	Swing 025 наполн.	Арт. № 1.006.2044
96 A	Иглодержатель endo clean	Арт. № 1.008.5164
-	Игла endo clean, белая (015)	Арт. № 1.006.2042
-	Игла endo clean, желтая (020)	Арт. № 1.006.2043
-	Игла endo clean, красная (025)	Арт. № 1.006.2044
97 A	Prep crown круглый	Арт. № 1.008.6384
98 A	Prep crown плоский	Арт. № 1.008.6386

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922) 49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
 Иваново (4932)77-34-06
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Сургут (3462)77-98-35
 Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://kavo.nt-rt.ru> || koc@nt-rt.ru